



# Ureofix® 500 Classic

## Gebruikersinstructie


### PATIËNT VERPLAATSEN

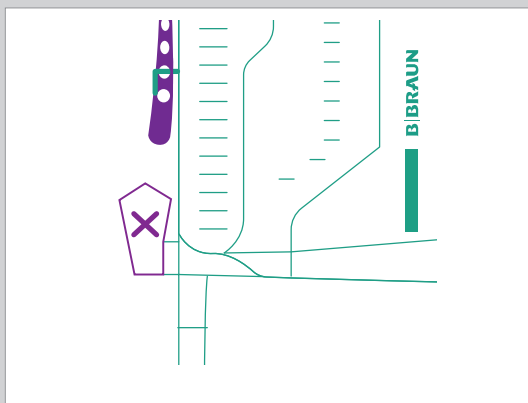


Wanneer een patiënt naar een ander bed wordt verplaatst, leeg de meetkamer volledig.




Sluit de schuifklem op de slang.



Leg het systeem plat op de achterkant.



Verplaats de patiënt.

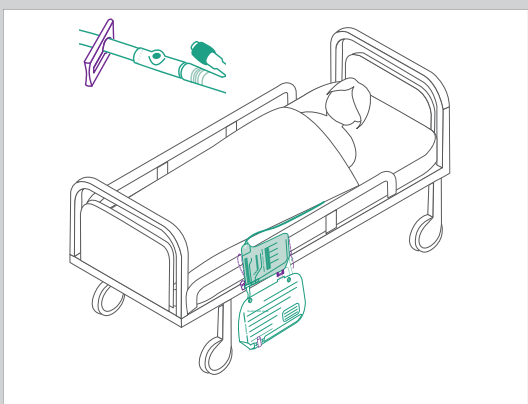

Breng het systeem onmiddellijk terug in verticale positie en heropen de schuifklem.